
GLDCSO3_Mod
PROTON.qm DMSO /opt/data Adv_Exp 36

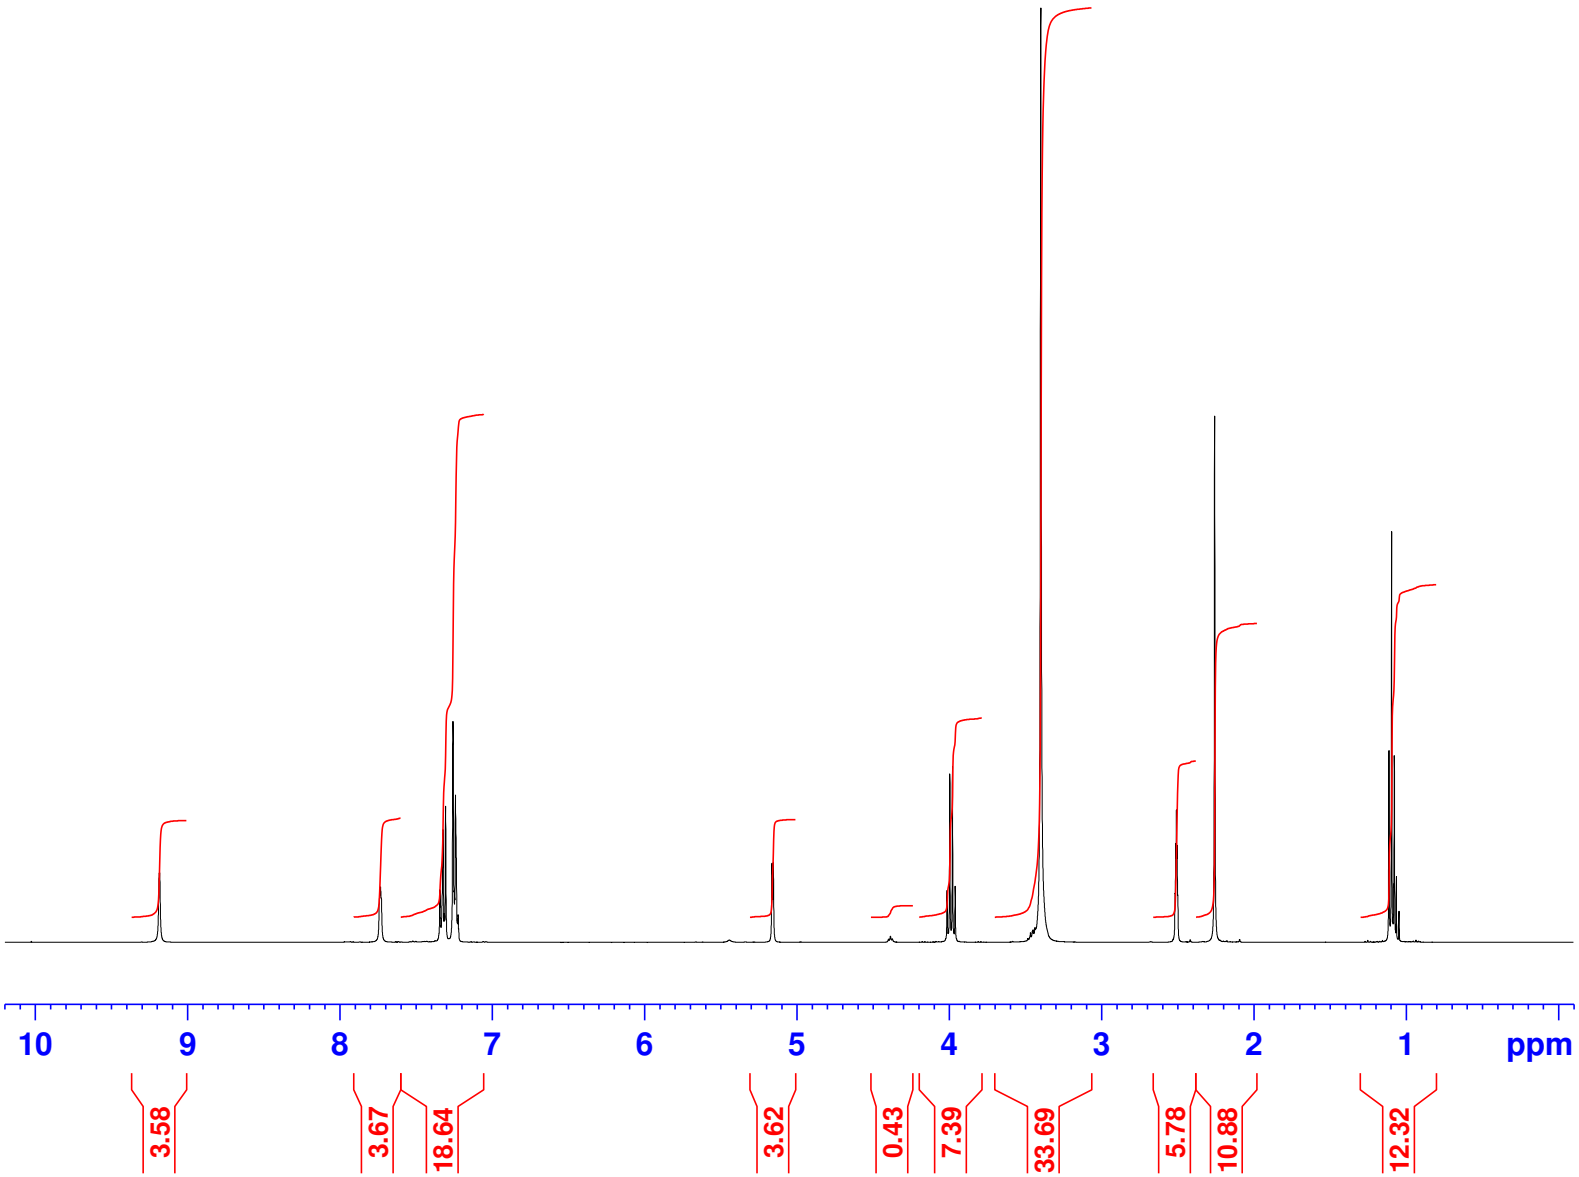


```
Current Data Parameters
NAME                  X_261015
EXPNO                      120
PROCNO                       1

F2 - Acquisition Parameters
Date_                 20261015
Time                     20.00 h
INSTRUM               aviii400
PROBHD    Z108618_0305 (
PULPROG                  zg30
TD                      65536
SOLVENT                  DMSO
NS                         16
DS                          0
SWH                   8223.685 Hz
FIDRES                0.250967 Hz
AQ                    3.9845889 sec
RG                        71.8
DW                       60.800 usec
DE                       10.54 usec
TE                       300.0 K
D1                 1.00000000 sec
TD0                         1
SFO1               400.2024714 MHz
NUC1                       1H
P0                       16.47 usec
P1                       49.42 usec
PLW1              19.95299911 W

F2 - Processing parameters
SI                      65536
SF                 400.2000000 MHz
WDW                        EM
SSB                         0
LB                       0.30 Hz
GB                          0
PC                       1.00
```