
TQO3_Trad
PROTON.qm DMSO /opt/data Adv_Exp 33

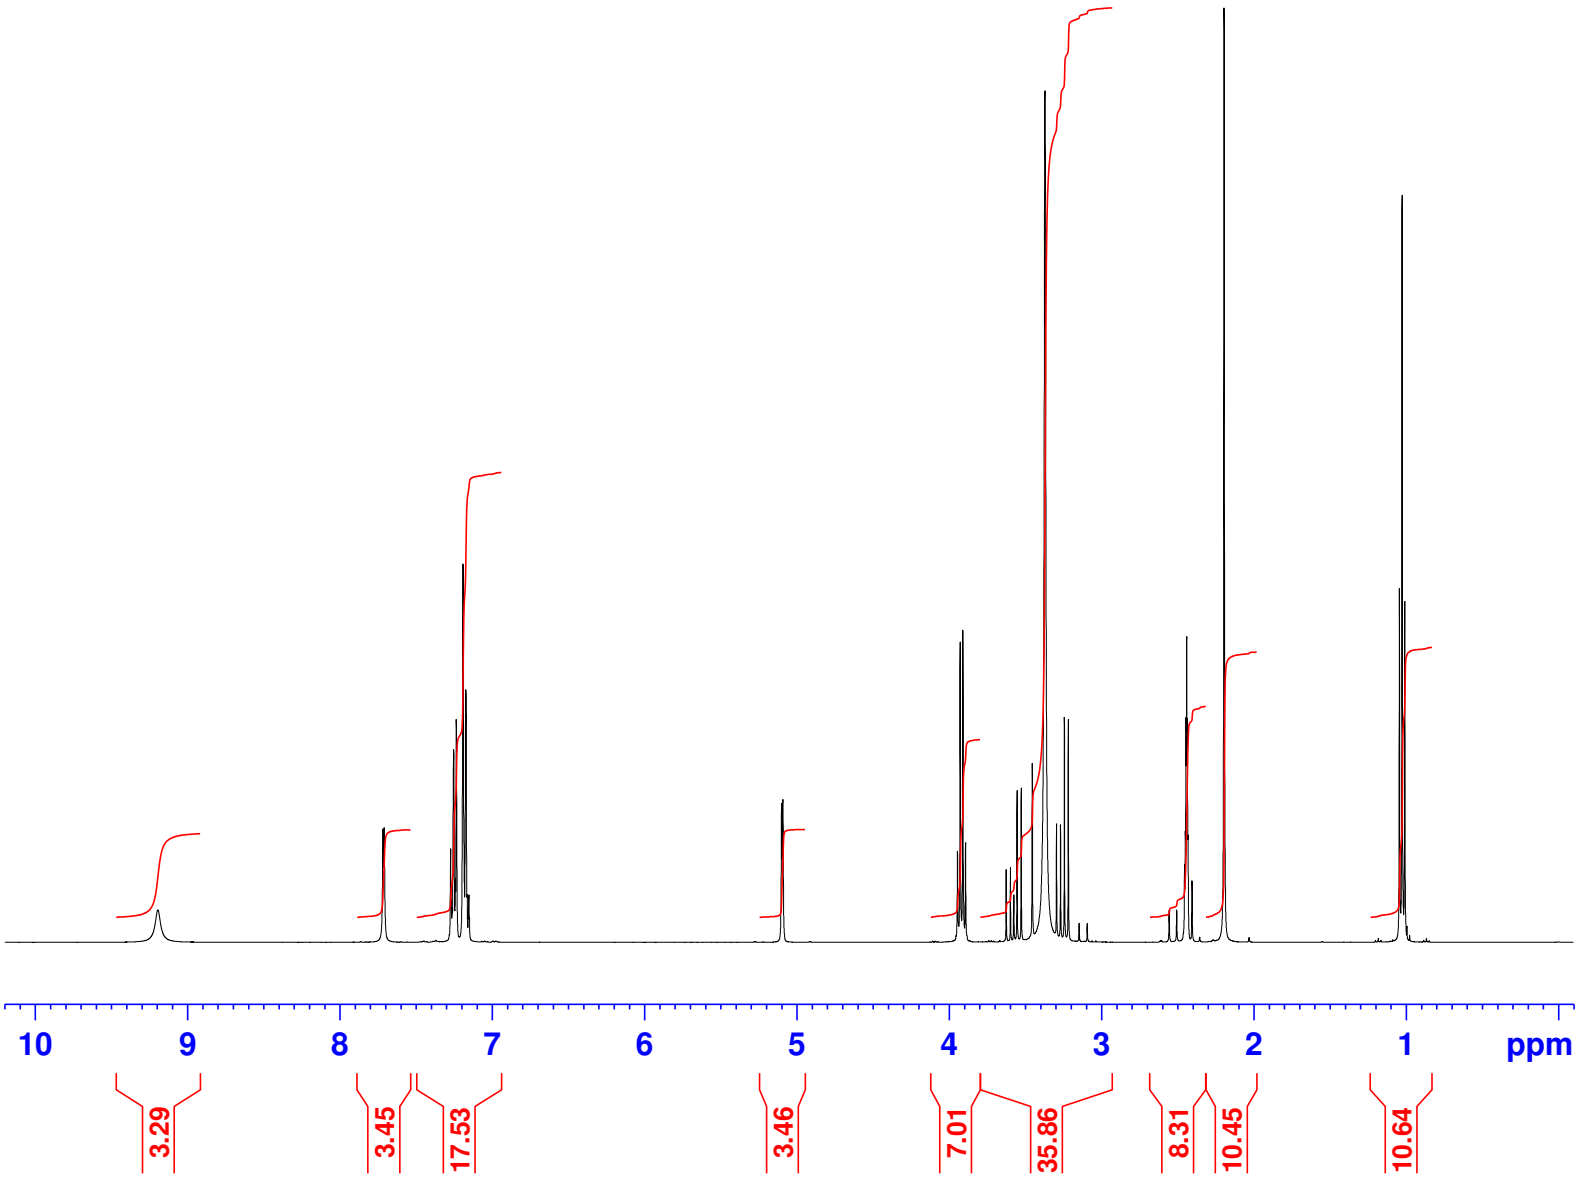


```
Current Data Parameters
NAME                 X_261015
EXPNO                      90
PROCNO                      1

F2 - Acquisition Parameters
Date_                20261015
Time                    18.57 h
INSTRUM              aviii400
PROBHD    Z108618_0305 (
PULPROG                  zg30
TD                      65536
SOLVENT                  DMSO
NS                         16
DS                          0
SWH                  8223.685 Hz
FIDRES               0.250967 Hz
AQ                   3.9845889 sec
RG                         64
DW                      60.800 usec
DE                      10.54 usec
TE                      300.0 K
D1                1.00000000 sec
TD0                         1
SFO1             400.2024714 MHz
NUC1                       1H
P0                      16.47 usec
P1                      49.42 usec
PLW1             19.95299911 W

F2 - Processing parameters
SI                      65536
SF               400.2000274 MHz
WDW                        EM
SSB                         0
LB                       0.30 Hz
GB                          0
PC                       1.00
```