
A.S-01
PROTON.qm CDCl3 /opt/data Adv_Exp 44

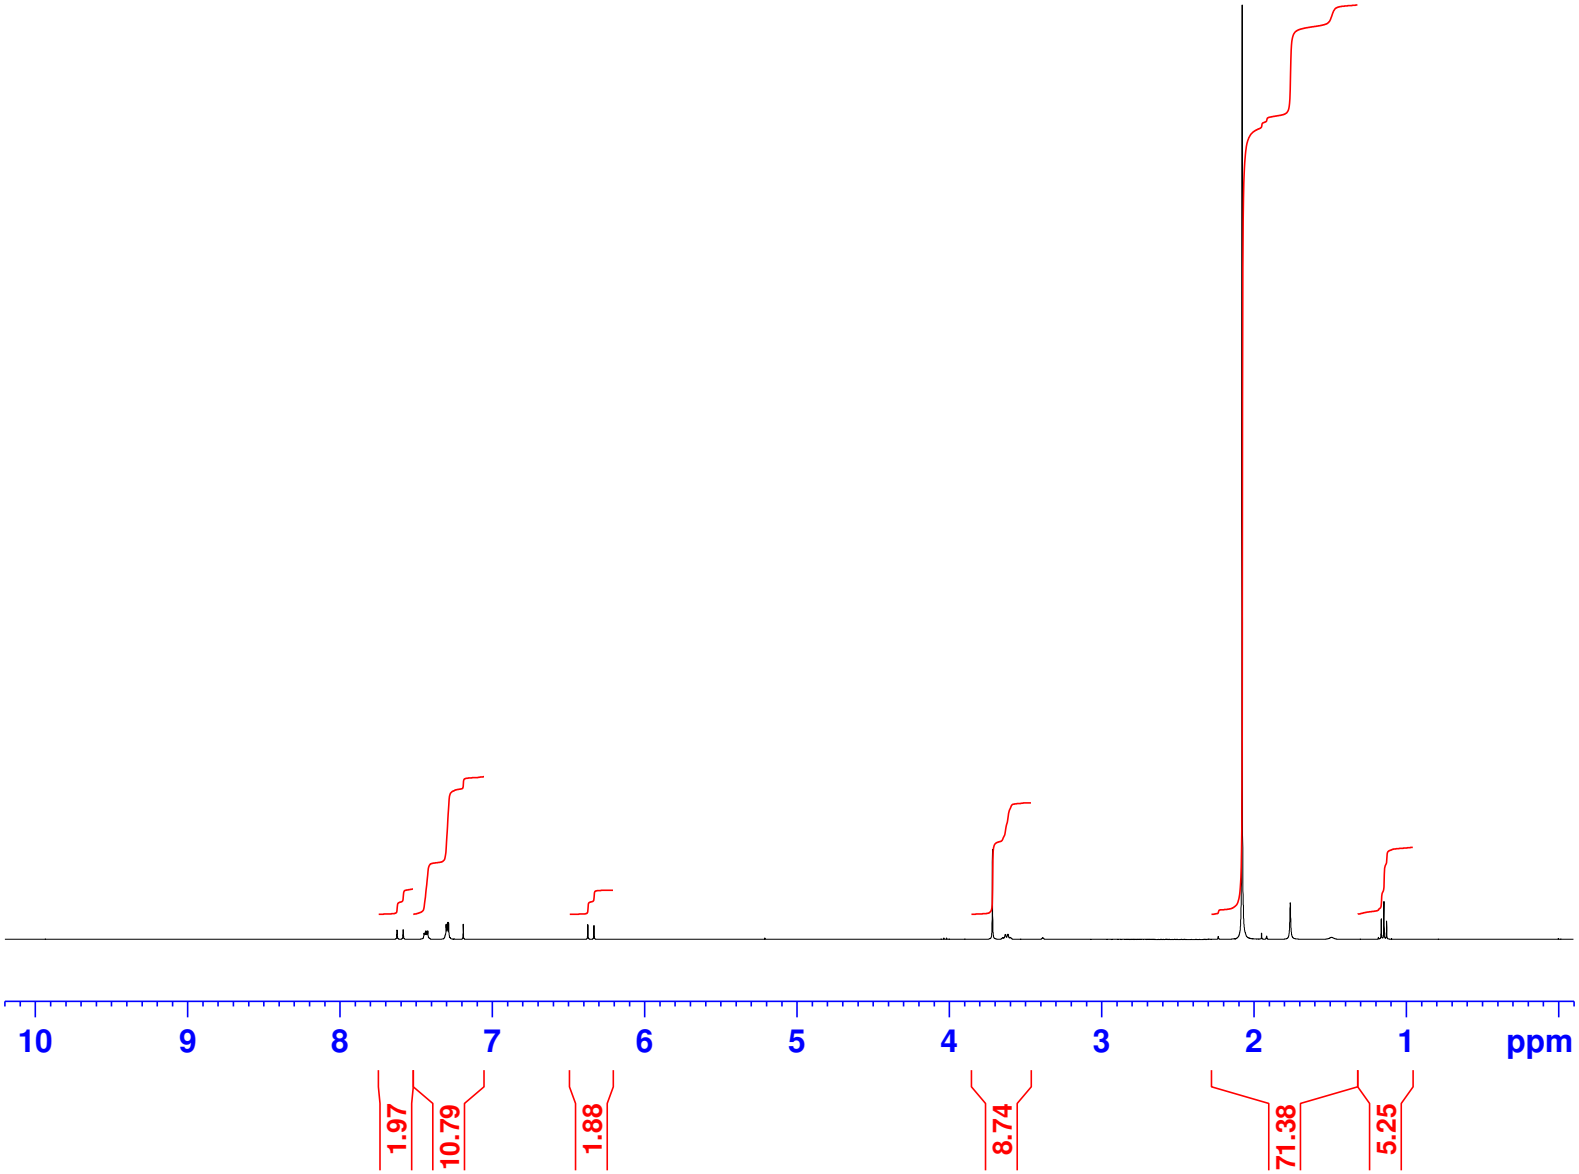


```
Current Data Parameters
NAME                  X_261016
EXPNO                      120
PROCNO                       1

F2 - Acquisition Parameters
Date_                 20261016
Time                      19.20 h
INSTRUM                aviii400
PROBHD    Z108618_0305 (
PULPROG                   zg30
TD                       65536
SOLVENT                  CDCl3
NS                          16
DS                           0
SWH                    8223.685 Hz
FIDRES                 0.250967 Hz
AQ                     3.9845889 sec
RG                         101
DW                        60.800 usec
DE                        10.54 usec
TE                        300.0 K
D1                  1.00000000 sec
TD0                          1
SFO1               400.2024714 MHz
NUC1                        1H
P0                        16.47 usec
P1                        49.42 usec
PLW1               19.95299911 W

F2 - Processing parameters
SI                       65536
SF                 400.2000374 MHz
WDW                         EM
SSB                          0
LB                        0.30 Hz
GB                           0
PC                        1.00
```