
A.L
PROTON.qm CDCl3 /opt/data Adv_Exp 45

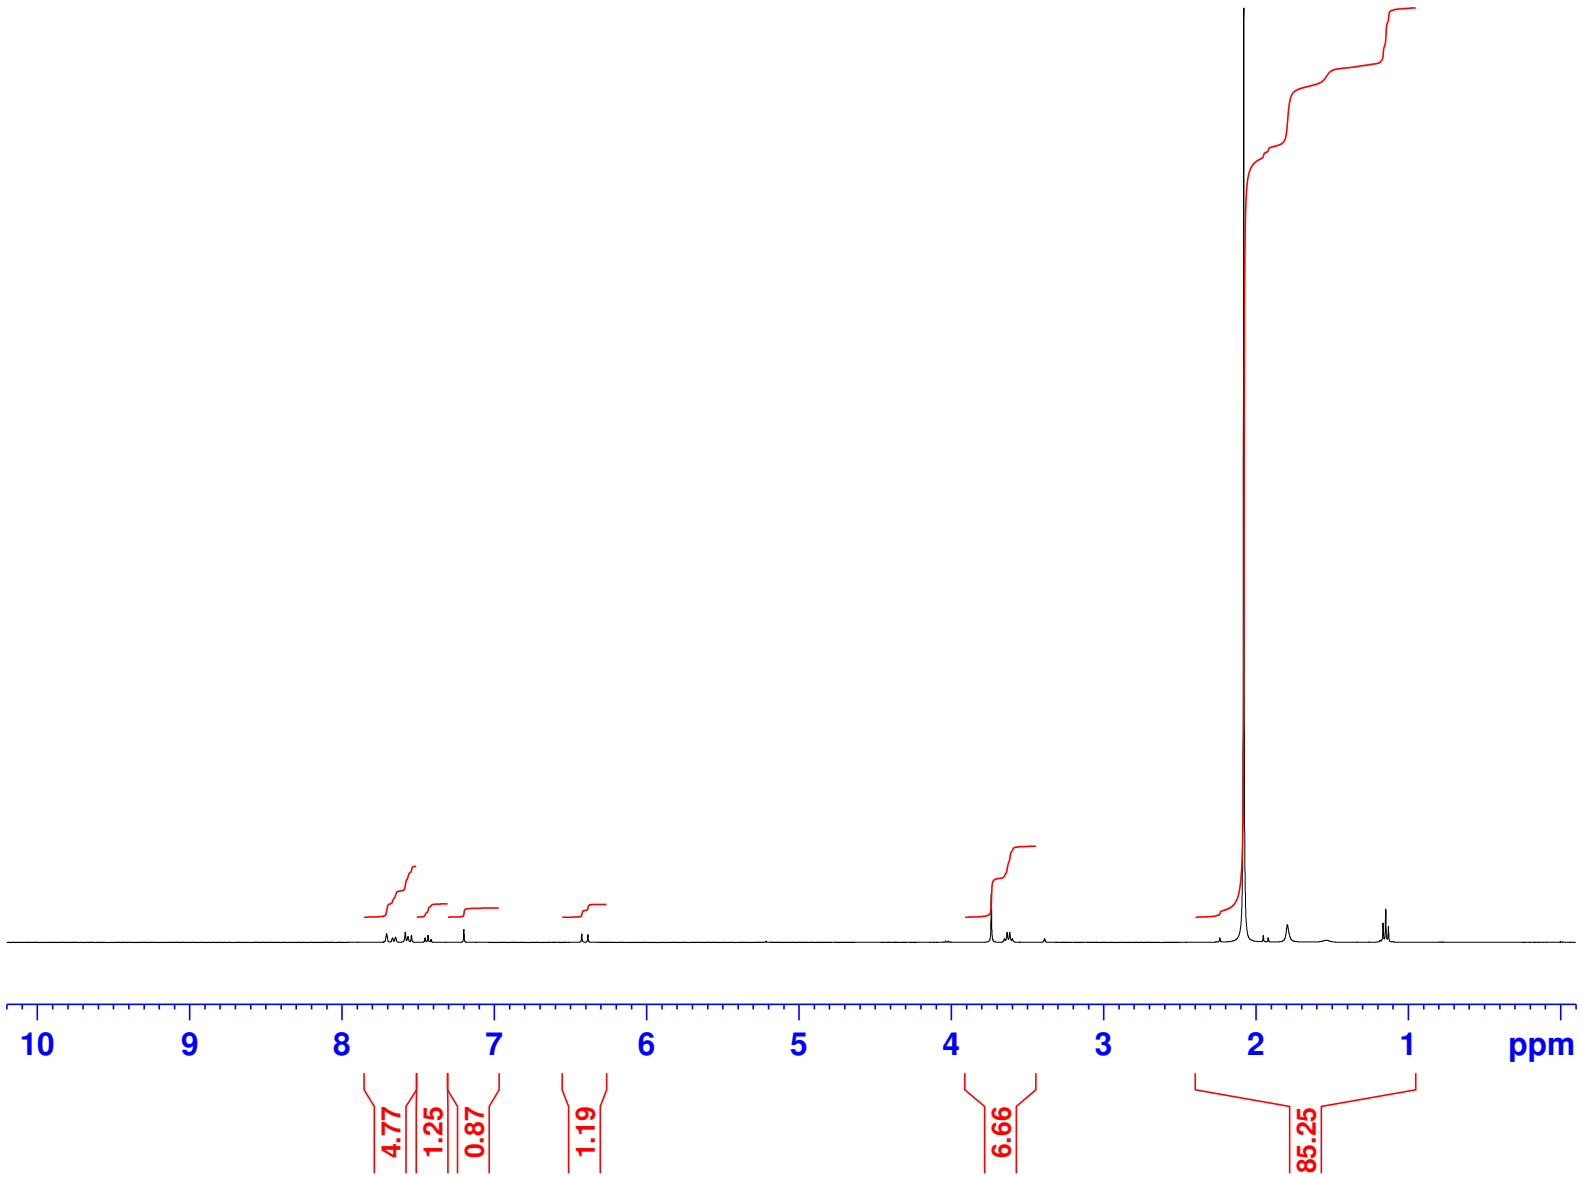


```
Current Data Parameters
NAME                  X_261016
EXPNO                      130
PROCNO                       1

F2 - Acquisition Parameters
Date_                 20261016
Time                     19.37 h
INSTRUM                aviii400
PROBHD    Z108618_0305 (
PULPROG                   zg30
TD                       65536
SOLVENT                  CDCl3
NS                          16
DS                           0
SWH                   8223.685 Hz
FIDRES                0.250967 Hz
AQ                    3.9845889 sec
RG                        90.5
DW                      60.800 usec
DE                      10.54 usec
TE                      300.0 K
D1                 1.00000000 sec
TD0                          1
SFO1               400.2024714 MHz
NUC1                        1H
P0                      16.47 usec
P1                      49.42 usec
PLW1               19.95299911 W

F2 - Processing parameters
SI                       65536
SF                 400.2000339 MHz
WDW                         EM
SSB                          0
LB                       0.30 Hz
GB                           0
PC                        1.00
```