
HW-03-Traditional
PROTON.qm DMSO /opt/data Adv_Exp 47

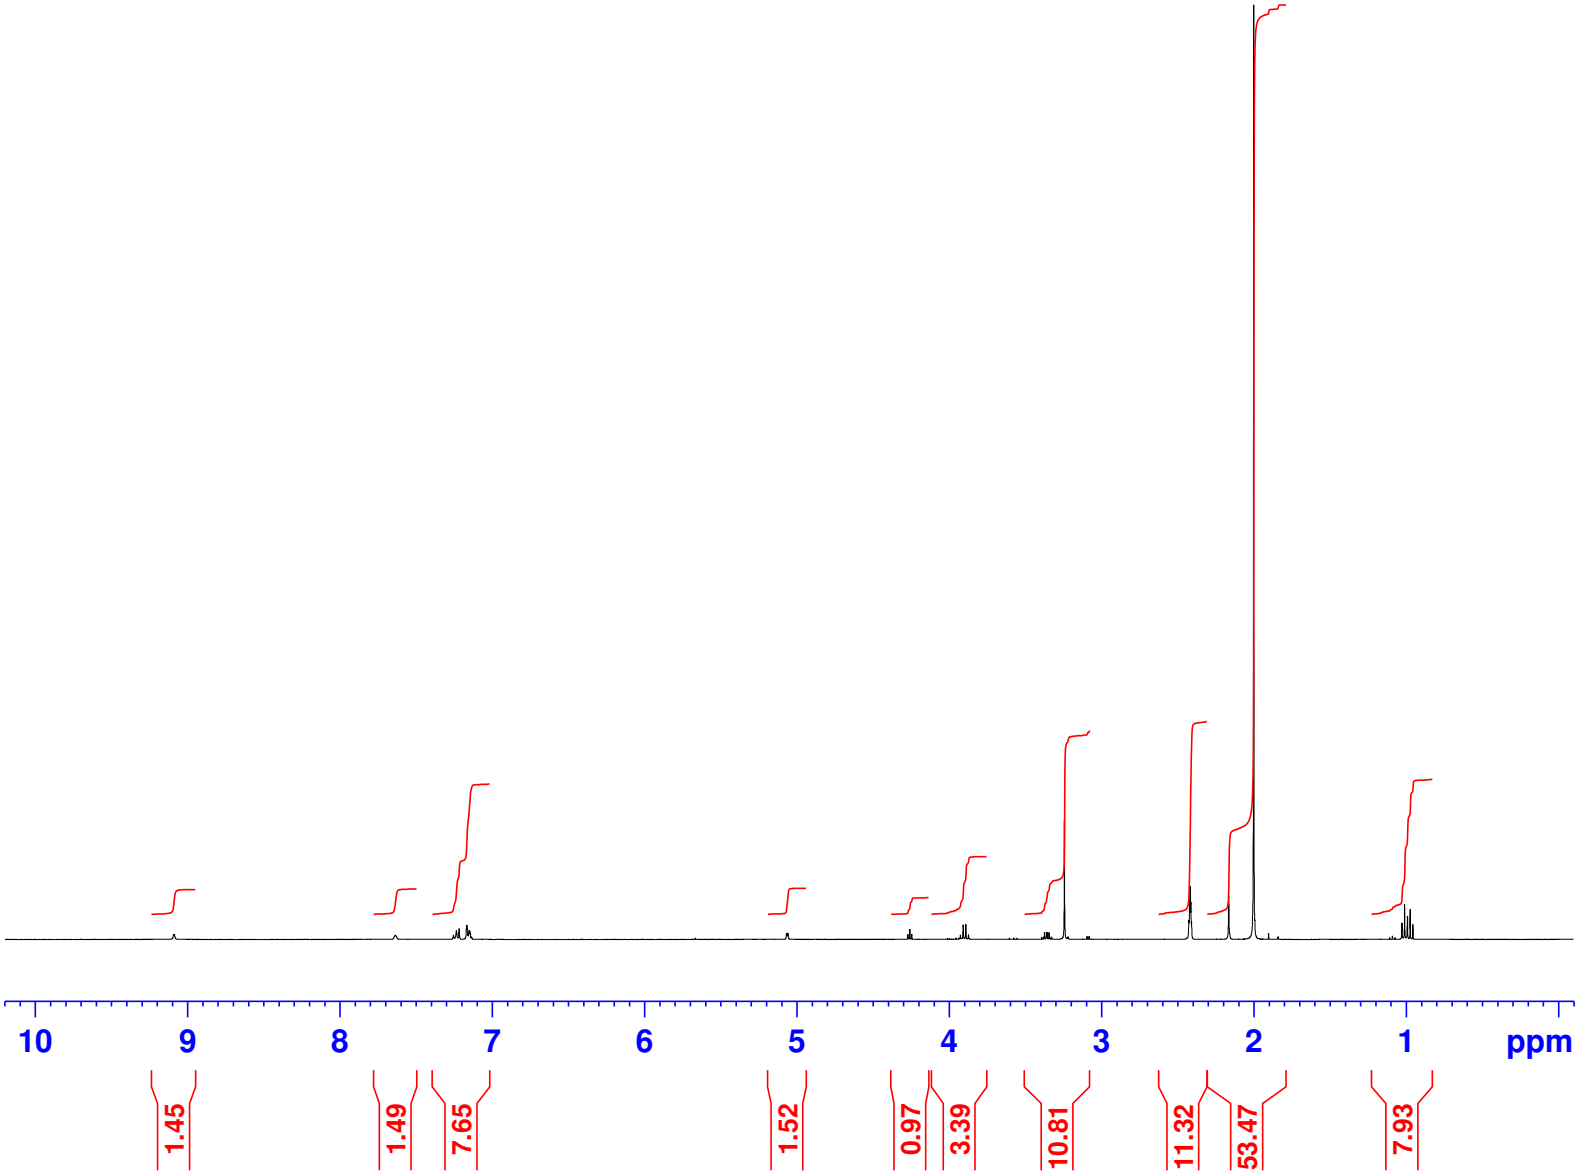


```
Current Data Parameters
NAME                  X_261016
EXPNO                      150
PROCNO                       1

F2 - Acquisition Parameters
Date_                 20261016
Time                     20.12 h
INSTRUM                aviii400
PROBHD    Z108618_0305 (
PULPROG                   zg30
TD                       65536
SOLVENT                   DMSO
NS                          16
DS                           0
SWH                   8223.685 Hz
FIDRES                0.250967 Hz
AQ                    3.9845889 sec
RG                        80.6
DW                       60.800 usec
DE                       10.54 usec
TE                       300.0 K
D1                 1.00000000 sec
TD0                          1
SFO1               400.2024714 MHz
NUC1                        1H
P0                       16.47 usec
P1                       49.42 usec
PLW1               19.95299911 W

F2 - Processing parameters
SI                       65536
SF                 400.2000362 MHz
WDW                         EM
SSB                          0
LB                       0.30 Hz
GB                           0
PC                        1.00
```