
Trad-O3-SK
PROTON.qm DMSO /opt/data Adv_Exp 50

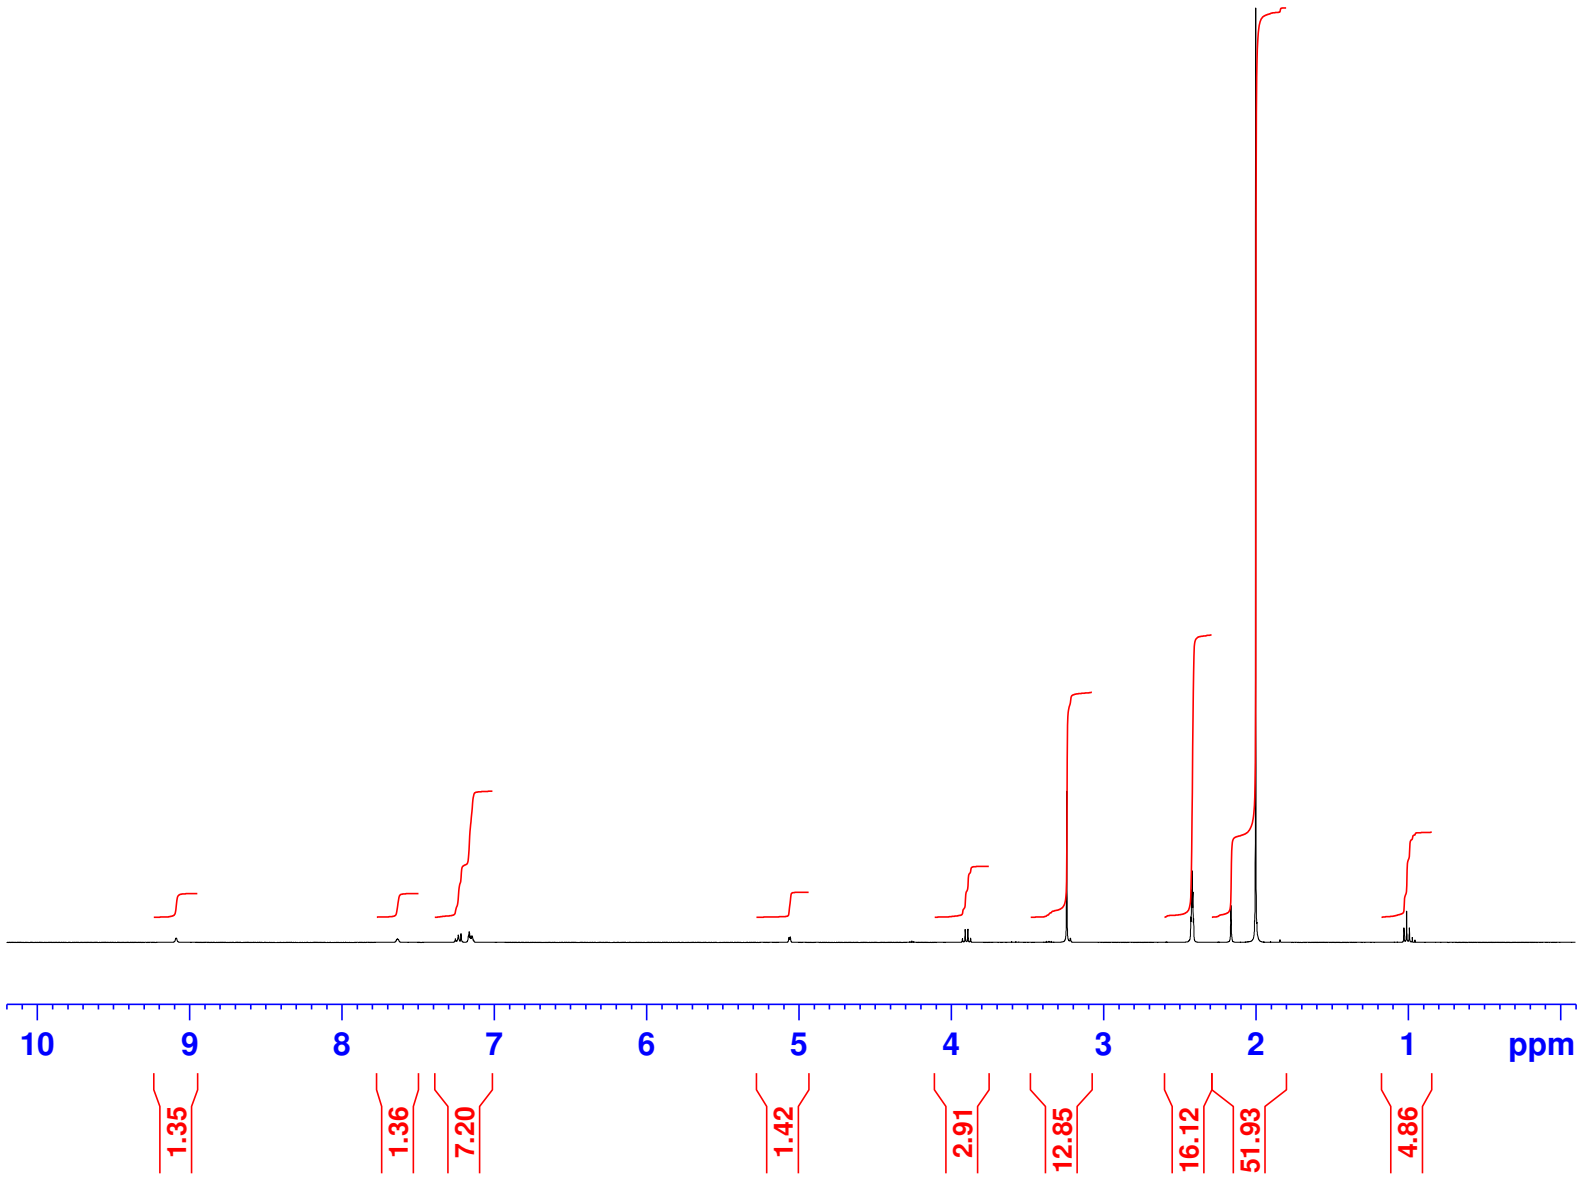


```
Current Data Parameters
NAME                  X_261016
EXPNO                      180
PROCNO                       1

F2 - Acquisition Parameters
Date_                 20261016
Time                     21.02 h
INSTRUM                aviii400
PROBHD   Z108618_0305 (
PULPROG                    zg30
TD                        65536
SOLVENT                    DMSO
NS                           16
DS                            0
SWH                    8223.685 Hz
FIDRES                 0.250967 Hz
AQ                     3.9845889 sec
RG                           101
DW                        60.800 usec
DE                        10.54 usec
TE                        300.0 K
D1                    1.00000000 sec
TD0                           1
SFO1                400.2024714 MHz
NUC1                         1H
P0                        16.47 usec
P1                        49.42 usec
PLW1                19.95299911 W

F2 - Processing parameters
SI                        65536
SF                  400.2000363 MHz
WDW                          EM
SSB                           0
LB                        0.30 Hz
GB                            0
PC                         1.00
```