
MMT-O3
PROTON.qm DMSO /opt/data Adv_Exp 52

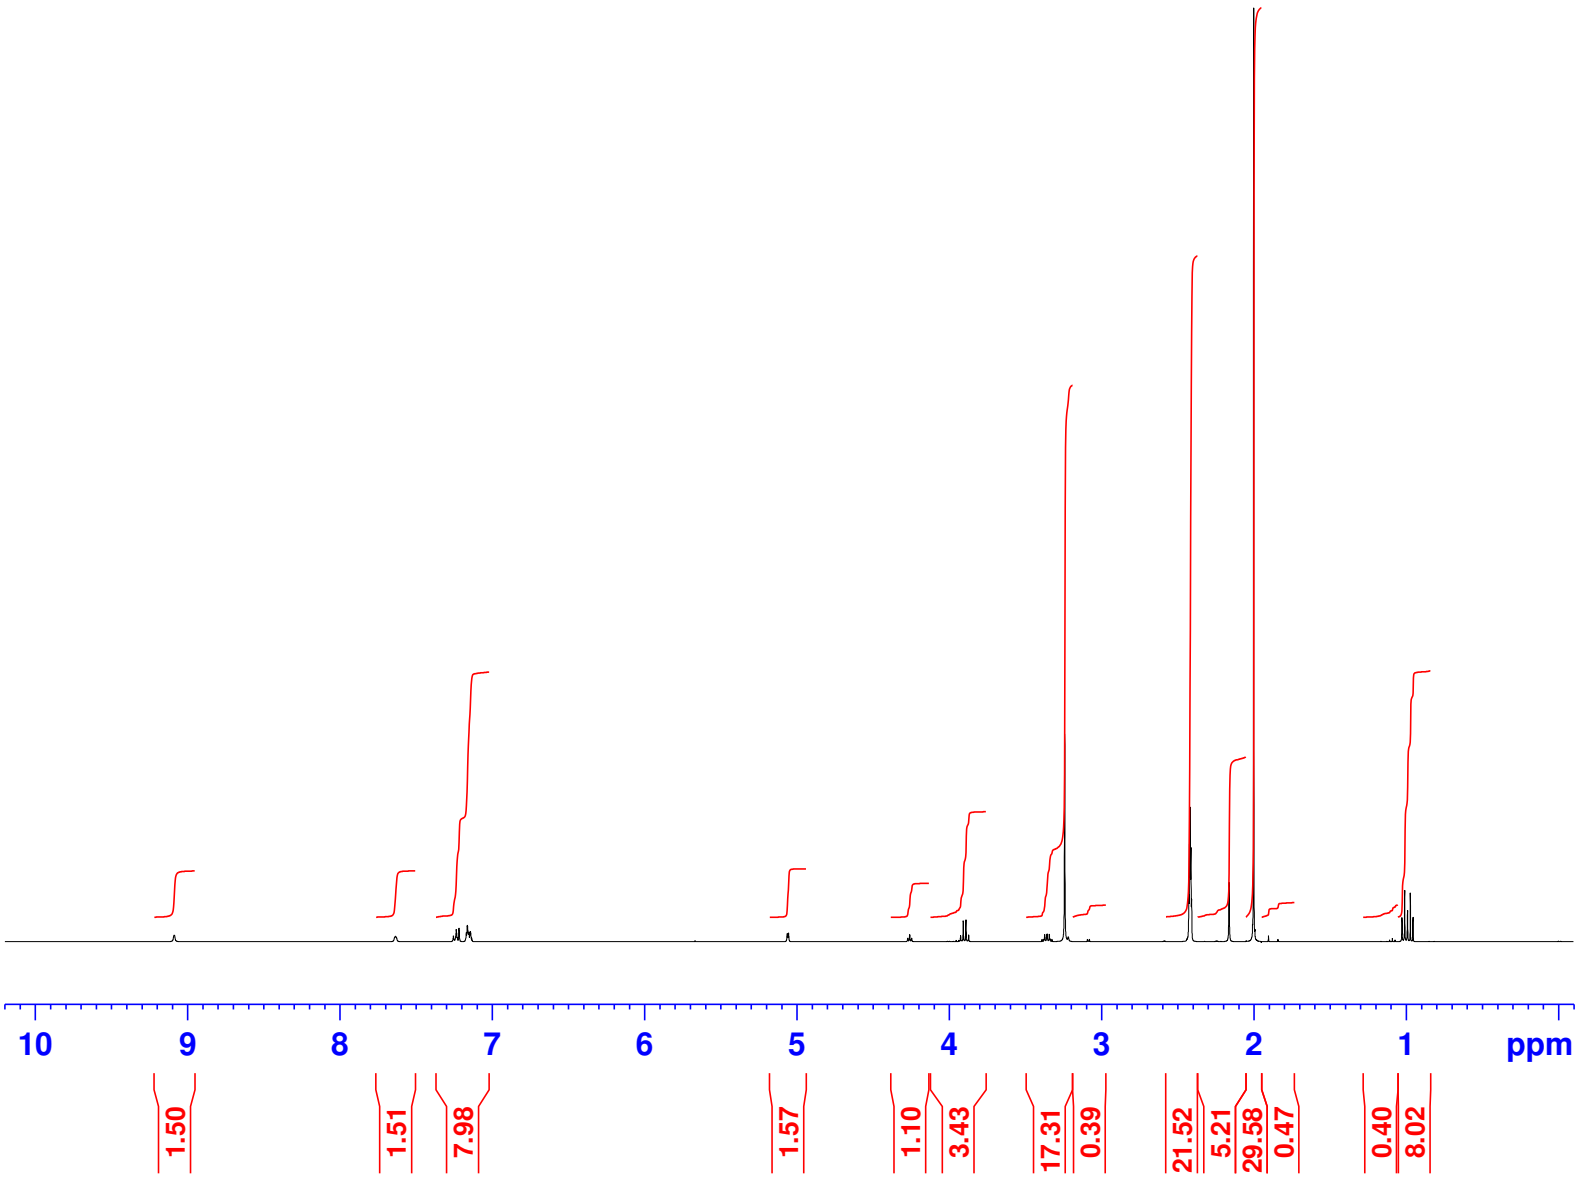


```
Current Data Parameters
NAME                 X_261016
EXPNO                     200
PROCNO                      1

F2 - Acquisition Parameters
Date_               20261016
Time                   21.36 h
INSTRUM              aviii400
PROBHD    Z108618_0305 (
PULPROG                 zg30
TD                     65536
SOLVENT                 DMSO
NS                        16
DS                         0
SWH                 8223.685 Hz
FIDRES              0.250967 Hz
AQ                  3.9845889 sec
RG                       128
DW                    60.800 usec
DE                    10.54 usec
TE                    300.0 K
D1                 1.00000000 sec
TD0                        1
SFO1             400.2024714 MHz
NUC1                      1H
P0                    16.47 usec
P1                    49.42 usec
PLW1             19.95299911 W

F2 - Processing parameters
SI                     65536
SF               400.2000363 MHz
WDW                       EM
SSB                        0
LB                    0.30 Hz
GB                         0
PC                     1.00
```