
SRO1-H
PROTON.qm CDCl3 /opt/data Adv_Exp 29

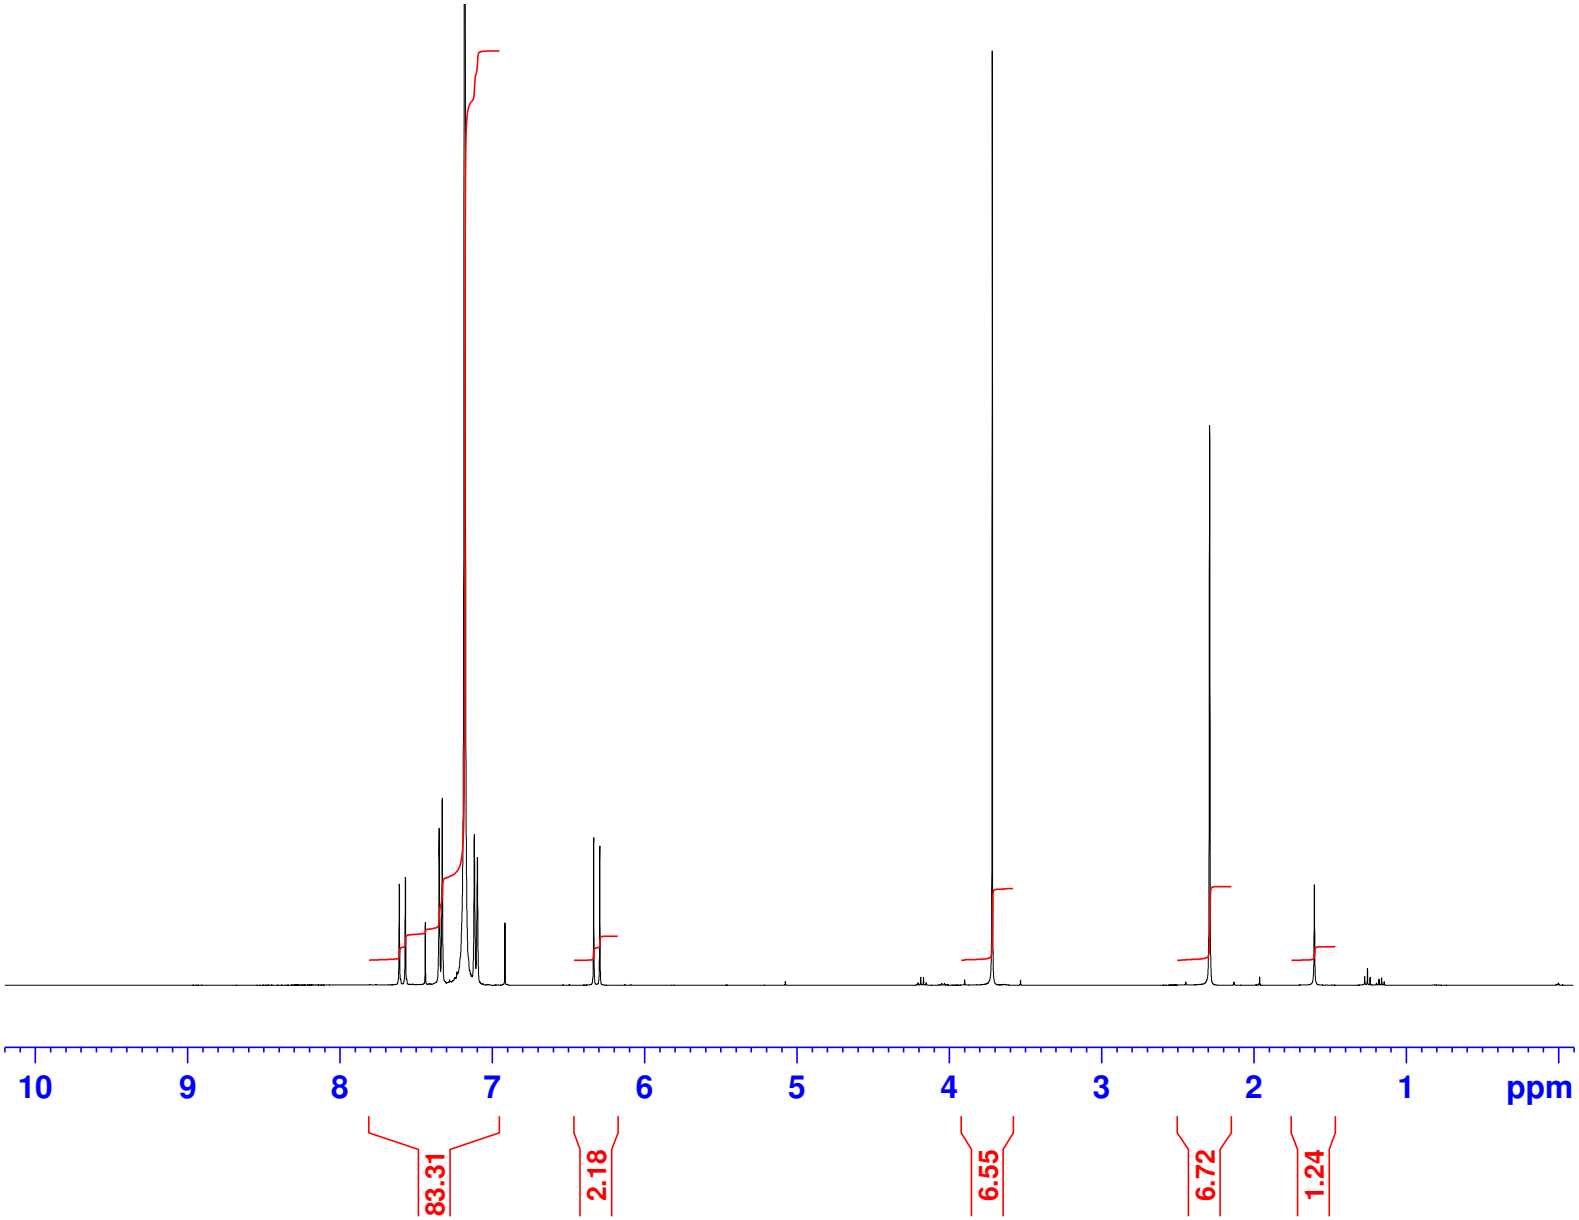


```
Current Data Parameters
NAME                 X_261030
EXPNO                      70
PROCNO                      1

F2 - Acquisition Parameters
Date_               20261030
Time                   17.53 h
INSTRUM              aviii400
PROBHD    Z108618_0305 (
PULPROG                 zg30
TD                     65536
SOLVENT                CDCl3
NS                        16
DS                         0
SWH                 8223.685 Hz
FIDRES              0.250967 Hz
AQ                  3.9845889 sec
RG                        32
DW                    60.800 usec
DE                    10.54 usec
TE                    300.0 K
D1                1.00000000 sec
TD0                        1
SFO1            400.2024714 MHz
NUC1                      1H
P0                    16.47 usec
P1                    49.42 usec
PLW1            19.95299911 W

F2 - Processing parameters
SI                     65536
SF              400.2000415 MHz
WDW                       EM
SSB                        0
LB                    0.30 Hz
GB                         0
PC                     1.00
```