
IBO1-H
PROTON.qm CDCl3 /opt/data Adv_Exp 30

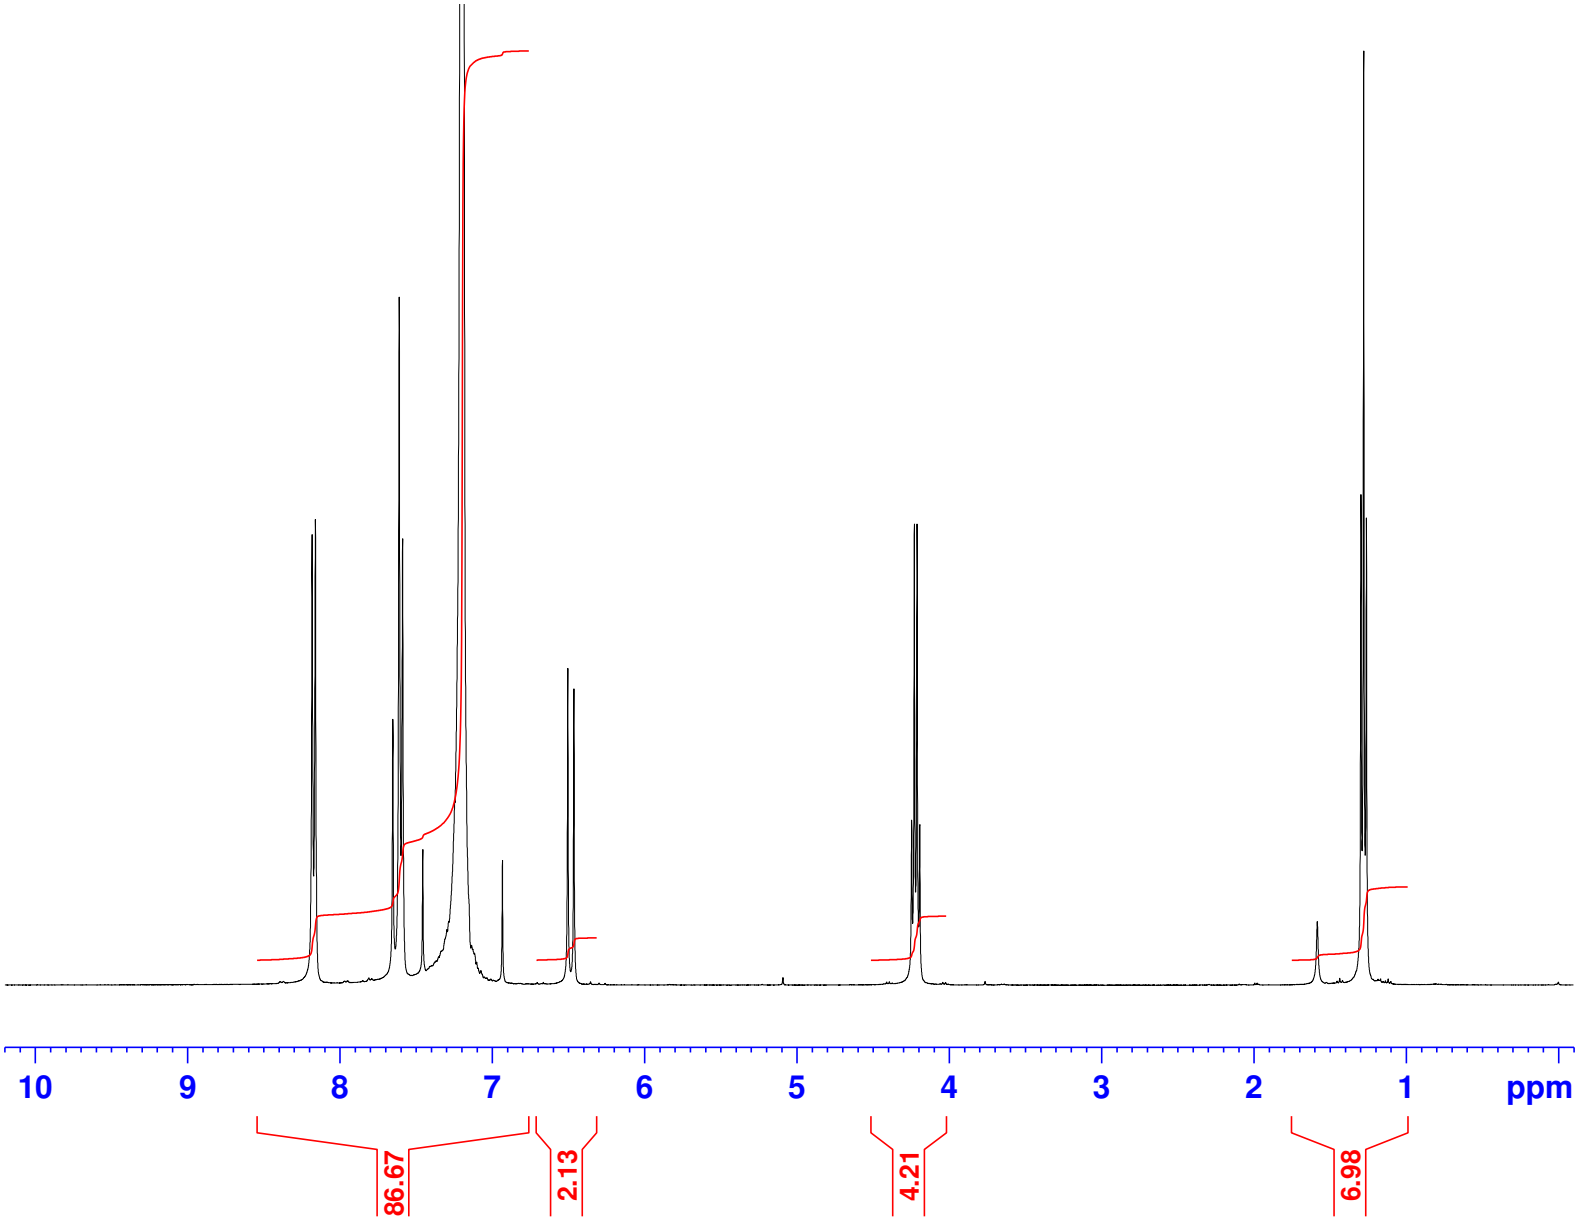


```
Current Data Parameters
NAME                  X_261030
EXPNO                       80
PROCNO                       1

F2 - Acquisition Parameters
Date_                 20261030
Time                     18.23 h
INSTRUM               aviii400
PROBHD   Z108618_0305 (
PULPROG                   zg30
TD                       65536
SOLVENT                  CDCl3
NS                          16
DS                           0
SWH                   8223.685 Hz
FIDRES                0.250967 Hz
AQ                    3.9845889 sec
RG                          32
DW                       60.800 usec
DE                       10.54 usec
TE                       300.0 K
D1                    1.00000000 sec
TD0                          1
SFO1                400.2024714 MHz
NUC1                        1H
P0                       16.47 usec
P1                       49.42 usec
PLW1                19.95299911 W

F2 - Processing parameters
SI                       65536
SF                  400.2000351 MHz
WDW                         EM
SSB                          0
LB                       0.30 Hz
GB                           0
PC                       1.00
```